

Taikomi standartai ir dokumentai:

LST EN ISO 4064-1:2017;
LST EN ISO 4064-2:2017;
LST EN ISO 4064-4:2014;
LST EN ISO 4064-5:2017;
OIML R 49-1:2013;
OIML R 49-2:2013;
WELMEC 7.2:2015.

Matavimo priemonė turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

1 Matavimo priemonės projektas

1.1 Konstrukcija

Ultragarsinį vientisąjį vandens skaitiklį QALCOSONIC W1 sudaro matavimo keitlys su pirminiu srauto jutikliu, elektroninis skaičiuotuvas ir rodmenų įtaisas. Plastikiniame skaitiklio korpuse sumontuoti plastikiniai matavimo ruožo įdėklai su dviem ultragarso keitliais (skaitikliams su srieginiu prijungimu G 2 ir jungėmis DN50 – su keturiais ultragarso keitliais). Tame pačiame korpuse sumontuotas skaitiklio elektroninis skaičiuotuvas ir skystųjų kristalų rodmenų įtaisas. Skaitiklio įtekėjimo atvamzdyje gali būti sumontuotas filtras-sietelis. Skaitiklio ištekėjimo atvamzdyje gali būti sumontuotas atbulinis vožtuvas (išskyrus skaitiklius su srieginiu prijungimu G ¾ ilgio 80 mm, G 1 ilgio 105 mm ir 110 mm, G 1½, bei jungėmis DN50).

Skaitiklis, priklausomai nuo modifikacijos, skirtas matuoti tiesioginiam srautui arba tiesioginiam ir atbuliniam srautui. Pratekėjęs atbulinio srauto tūris registruojamas atskirame registre ir papildomai gali būti atimamas iš tiesioginio srauto tūrio.

Skaitiklis maitinamas iš nekeičiamos 3,6 V DC ličio baterijos (vienos arba dviejų).



1 pav. Vandens skaitiklis QALCOSONIC W1, $Q_3 = 1,6/2,5/4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, su srieginiu prijungimu G ¾ arba G 1 (skaitiklio dizainas pirminės versijos)



2 pav. Vandens skaitiklis QALCOSONIC W1, $Q_3 = 1,6/2,5/4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, su srieginiu prijungimu G ¾ arba G 1 (skaitiklio dizainas versijos „n“)



3 pav. Vandens skaitiklis QALCASONIC W1,
 $Q_3 = 6,3/10 \text{ m}^3$, su srieginiu prijungimu
G 1¼ arba G 1½



4 pav. Vandens skaitiklis QALCASONIC W1,
 $Q_3 = 10/16/25 \text{ m}^3$, su srieginiu prijungimu G 2



5 pav. Vandens skaitiklis QALCASONIC W1,
 $Q_3 = 16/25/40 \text{ m}^3$, su jungėmis DN50

1.2 Jutiklis

Ultragarsinis srauto jutiklis.

1.3 Matavimo rezultatų apdorojimas

Srauto matavimo principas pagrįstas ultragarso signalo sklaidimo laiko matavimu vandens srauto tekėjimo kryptimi ir prieš srauto tekėjimo kryptį. Išmatuotų laikų skirtumas yra proporcingas per skaitiklį pratekėjusio vandens srautui, kurį apskaičiuoja skaitiklio skaičiuotuvas.

1.4 Matavimo rezultato rodmuo

Išmatuotas vandens tūris pateikiamas dviejų eilučių skystųjų kristalų rodmenų įtaise.

Viršutinė eilutė: 9 skilčių, skirta pratekėjusio vandens tūrio rodmenims.

Rodmenys darbo režime : m^3 , trys skaitmenys po kablelio.

Rodmenys patikros režime : m^3 , šeši skaitmenys po kablelio.

Apatinė eilutė: 5 skilčių, skirta momentinio srauto parodymui m^3/h ir informaciniams simboliams.

Handwritten signature

1.5 Papildoma įranga ir funkcijos, kuriems taikomi Direktyvos reikalavimai

Nėra.

1.6 Techninė dokumentacija

Ultragarsinis vandens skaitiklis QALCOSONIC W1. Techninis aprašas, įrengimo ir naudojimo vadovas: PE_QW1_V13_EN, 2022-12.

Surinkimo brėžinys N10.0001.00.00-01, 2021-12-07.

Surinkimo brėžinys N10.0013.00.00-01, 2018-08-24.

Surinkimo brėžinys N14.0010.00.00-00, 2020-10-01.

Surinkimo brėžinys N10.0033.00.00-00, 2020-10-01.

Surinkimo brėžinys N14.013.00.00 W1 DN40 L300, 2020-12-11.

Surinkimo brėžinys N10.0052.100.00-00, 2021-10-15.

Surinkimo brėžinys N10.0055.100.00-00, 2021-10-15.

Surinkimo brėžinys N10.0043.00.00-00, 2020-12-11.

Kiti dokumentai, kuriais remiantis išduotas šis sertifikatas, saugomi byloje Nr. LEI-12-MP-131.22.

1.7 Įranga ir funkcijos, kuriems netaikomi Direktyvos reikalavimai

Skaitiklyje integruota NFC (artimojo ryšio) sąsaja, skirta duomenų nuskaitymui. Taip pat skaitiklyje integruota optinio ryšio sąsaja pagal LST EN 62056-21 reikalavimus, skirta duomenų nuskaitymui M-Bus protokolu, skaitiklio parametrų nustatymui ir optinių impulsų išvedimui patikros režime.

Skaitiklyje sumontuota viena iš šių belaidžio ryšio sąsajų:

- RF 868 MHz;
- RF 433 MHz;
- RF 915 MHz;
- RF 920,5 MHz;
- NB-IoT, darbiniai dažniai B1, B3, B5, B8, B20, B28.

RF ryšio sąsajomis duomenys gali būti perduodami šiais protokolais:

- W-M-Bus-T1;
- W-M-Bus-T2;
- W-M-Bus-S1;
- W-M-Bus-C1;
- SIGFOX;
- LORA WAN;
- CoAP.

Papildomai (specialiai užsakant, tik skaitikliams su srieginiu prijungimu G 2 ir jungėmis DN50) skaitiklyje gali būti sumontuota viena arba abi toliau nurodytos laidinio ryšio sąsajos (kabelio ilgis 1,5 m):

- M-Bus;
- laidinė impulsų išvestis.

2 Techniniai duomenys

2.1 Vardinės veikimo sąlygos

2.1.1 Matuojamasis dydis

Pratekėjusio vandens tūris, parodomas skystųjų kristalų rodmenų įtaise.



2.1.2 Matavimo ribos

Vandens skaitiklio QALCASONIC W1 matavimo ribos ir pagrindinės techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje :

1 lentelė

Srautas, m ³ /h				Srautų santykis R, Q ₃ /Q ₁	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtrą-sietelį
Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂				
1,6	2,0	0,020	0,032	80	G ¾	80 ¹ ; 105; 110; 115 ¹ ; 165;170	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 16
1,6	2,0	0,010	0,016	160	G ¾		
1,6	2,0	0,0064	0,010	250	G ¾		
1,6	2,0	0,005	0,008	315	G ¾		
1,6	2,0	0,004	0,0064	400	G ¾		
2,5	3,125	0,031	0,050	80	G ¾	80 ¹ ; 105; 110; 115 ¹ ; 165;170	Tiesioginiam srautui: Δp 25/ Δp 25 Atbuliniam srautui: Δp 25/ Δp 40
2,5	3,125	0,0156	0,025	160	G ¾		
2,5	3,125	0,010	0,016	250	G ¾		
2,5	3,125	0,0062	0,010	400	G ¾		
2,5	3,125	0,0031	0,005	800	G ¾		
2,5	3,125	0,031	0,050	80	G 1	105; 110; 130;165; 190	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 16
2,5	3,125	0,0156	0,025	160	G 1		
2,5	3,125	0,010	0,016	250	G 1		
2,5	3,125	0,0062	0,010	400	G 1		
4,0	5,0	0,050	0,080	80	G 1	105; 110; 130; 165; 190	Tiesioginiam srautui: Δp 25/ Δp 40 ² Atbuliniam srautui: Δp 25/ Δp 40
4,0	5,0	0,025	0,040	160	G 1		
4,0	5,0	0,016	0,026	250	G 1		
4,0	5,0	0,010	0,016	400	G 1		
4,0	5,0	0,005	0,008	800	G 1		
6,3	7,875	0,079	0,126	80	G 1¼	260	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 25/ Δp 40
6,3	7,875	0,040	0,063	160	G 1¼		
6,3	7,875	0,0252	0,040	250	G 1¼		
6,3	7,875	0,016	0,0252	400	G 1¼		
6,3	7,875	0,008	0,013	800 ³	G 1¼		
6,3	7,875	0,079	0,126	80	G 1½	260	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 16
6,3	7,875	0,040	0,063	160	G 1½		
6,3	7,875	0,0252	0,040	250	G 1½		
6,3	7,875	0,016	0,0252	400	G 1½		
10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 1¼	260	Tiesioginiam srautui: Δp 63/ Δp 63 Atbuliniam srautui: Δp 63/ – ⁴
10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 1¼		
10,0	12,5	0,040	0,064	250	G 1¼		
10,0	12,5	0,025	0,040	400	G 1¼		
10,0	12,5	0,0125	0,020	800 ³	G 1¼		
10,0	12,5	0,010	0,016	1000 ³	G 1¼	260	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 25/ Δp 25
10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 1½		
10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 1½		
10,0	12,5	0,025	0,040	400	G 1½		
10,0	12,5	0,0125	0,020	800 ³	G 1½		
10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 2	300	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 16
10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 2		
10,0	12,5	0,040	0,064	250	G 2		



Srautas, m ³ /h				Srautų santykis R, Q ₃ /Q ₁	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė: be filtro/ sumontavus filtrą-sietelį
Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂				
16,0	20,0	0,200	0,320	80	G 2	300	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 16
16,0	20,0	0,100	0,160	160	G 2		
16,0	20,0	0,064	0,102	250	G 2		
16,0	20,0	0,040	0,064	400	G 2		
16,0	20,0	0,020	0,032	800 ³	G2		
25,0	31,25	0,3125	0,500	80	G 2	300	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 25
25,0	31,25	0,156	0,250	160	G 2		
25,0	31,25	0,100	0,160	250	G 2		
25,0	31,25	0,0625	0,100	400	G 2		
25,0	31,25	0,0312	0,050	800 ³	G 2		
16,0	20,0	0,200	0,320	80	DN50	200	Tiesioginiam ir atbuliniam srautui: Δp 16/ Δp 16
16,0	20,0	0,100	0,160	160	DN50		
16,0	20,0	0,064	0,102	250	DN50		
16,0	20,0	0,040	0,064	400 ³	DN50		
25,0	31,25	0,3125	0,500	80	DN50		
25,0	31,25	0,156	0,250	160	DN50	200	Tiesioginiam srautui: Δp 16/ Δp 16 Atbuliniam srautui: Δp 16/ – ⁴
25,0	31,25	0,100	0,160	250	DN50		
25,0	31,25	0,0625	0,100	400	DN50		
25,0	31,25	0,0312	0,050	800 ³	DN50		
40,0	50,0	0,500	0,800	80	DN50		
40,0	50,0	0,250	0,400	160	DN50	200	Tiesioginiam srautui: Δp 16/ Δp 16 Atbuliniam srautui: Δp 16/ – ⁴
40,0	50,0	0,160	0,256	250	DN50		
40,0	50,0	0,100	0,160	400	DN50		
40,0	50,0	0,050	0,080	800 ³	DN50		

Pastabos:

¹ – skaitikliai ilgio l = 80 mm ir l = 115 mm gaminami tik pirminio dizaino versijos.

² – skaitikliams Q₃ = 4 m³/h, srieginio prijungimo G 1, l = 190 mm, sumontavus filtrą-sietelį, galioja slėgio nuostolių klasė Δp 40. Visų kitų ilgių Q₃ = 4 m³/h skaitikliams su filtru galioja slėgio nuostolių klasė Δp 25.

³ – šis srautų santykis galioja tik skaitikliams temperatūros klasės T30.

⁴ – skaitikliai su atbulinio srauto matavimo funkcija montuojami tik be filtro-sietelio.

2.1.3 Skaitiklio temperatūros klasės ir didžiausiosios leidžiamosios paklaidos

Skaitiklio temperatūros klasės ir didžiausiosios leidžiamosios paklaidos pateiktos 2 lentelėje:

2 lentelė

Skaitiklio temperatūros klasė	Vandens temperatūros ribos	Didžiausiosios leidžiamosios paklaidos
T30	nuo 0,1 °C iki 30 °C	± 5 % srauto ribose Q ₁ ≤ Q < Q ₂ ± 2 % srauto ribose Q ₂ ≤ Q ≤ Q ₄
T50	nuo 0,1 °C iki 50 °C	± 5 % srauto ribose Q ₁ ≤ Q < Q ₂ ± 2 % srauto ribose Q ₂ ≤ Q ≤ Q ₄ (esant vandens temperatūrai nuo 0,1 °C iki 30 °C) ± 3 % srauto ribose Q ₂ ≤ Q ≤ Q ₄ (esant vandens temperatūrai nuo 30 °C iki 50 °C)
T30/90	nuo 30 °C iki 90 °C	± 5 % srauto ribose Q ₁ ≤ Q < Q ₂ ± 3 % srauto ribose Q ₂ ≤ Q ≤ Q ₄

Handwritten signature

Skaitiklio temperatūros klasė	Vandens temperatūros ribos	Didžiausiosios leidžiamosios paklaidos
T90	nuo 0,1 °C iki 90 °C	$\pm 5\%$ srauto ribose $Q_1 \leq Q < Q_2$ $\pm 2\%$ srauto ribose $Q_2 \leq Q \leq Q_4$ (esant vandens temperatūrai nuo 0,1 °C iki 30 °C) $\pm 3\%$ srauto ribose $Q_2 \leq Q \leq Q_4$ (esant vandens temperatūrai nuo 30 °C iki 90 °C)

2.1.4 Aplinkos sąlygos/paveikieji dydžiai

Aplinkos temperatūros ribos : nuo -15 °C iki 70 °C;
Drėgmė : besikondensuojanti;
Montavimo vieta : uždaroje patalpoje arba lauke;
Elektromagnetinė aplinka : klasė E2;
Korpuso apsaugos laipsnis : IP68.

2.2 Kitos veikimo sąlygos

2.2.1 Didžiausias leidžiamasis darbinis slėgis

Vandens skaitiklio didžiausias leidžiamasis darbinis slėgis yra 1,6 MPa (MAP 16).

2.2.2 Vandens skaitiklio montavimo padėtis

Vandens skaitiklis gali būti montuojamas horizontaliai, vertikalčiai arba nuolydyje.

3 Sąajos ir suderinamumo sąlygos

Skaitiklio sąajos, nurodytos šio priedo 1.7 punkte.

4 Reikalavimai gamybai, naudojimo pradžiai ir naudojimui

4.1 Reikalavimai tolygiai gamybai užtikrinti

Po gamybos ir derinimo proceso vandens skaitikliams atliekami bandymai pagal LST EN ISO 4064-2 10.1 punkto reikalavimus. Skaitiklių paklaidos turi neviršyti didžiausių leidžiamųjų paklaidų, nurodytų Direktyvos 2014/32/ES priede III (MI-001).

Skaitikliai bandomi, esant šioms srautams:

tarp Q_1 ir $1,1Q_1$

tarp Q_2 ir $1,1Q_2$

tarp $0,9Q_3$ ir Q_3 .

T30 ir T50 klasės vandens skaitikliai bandomi $20\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$ temperatūros vandeniui.

T30/90 klasės vandens skaitikliai bandomi $50\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$ temperatūros vandeniui.

T90 klasės vandens skaitikliai bandomi $20\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$ ir $50\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$ temperatūros vandeniui.

4.2 Reikalavimai naudojimo pradžiai

Vandens skaitiklis QALCASONIC W1 turi būti įrengtas pagal techninio aprašo, nurodyto 1.6 punkte, reikalavimus.

Tiesios atkarpų dalys prieš ir už vandens skaitiklio nebūtinės (skaitiklio srauto profilio jautrumo klasė U0 D0).

Al. M. V.

4.3 Reikalavimai pastoviam naudojimui

Nėra specialių reikalavimų.

5 Matavimo proceso kontrolė pradėjus naudoti matavimo priemonę

5.1 Dokumentuota procedūra

Nėra.

5.2 Specialūs įrenginiai ar programinė įranga

- optinė nuskaitymo galvutė, atitinkanti LST EN 62056-21 standartą su spec. laikikliu;
- serviso programinė įranga **W1 TOOL**.

5.3 Techninės ir programinės įrangos identifikavimas

Techninės įrangos identifikavimas:

- žr. šio priedo 1 – 5 paveikslus.

Programinės įrangos identifikavimas. Programinės įrangos versijos numeris yra:

- **1.03** skaitikliams su srieginiu prijungimu G $\frac{3}{4}$, G 1, G $1\frac{1}{4}$, G $1\frac{1}{2}$ (kai naudojamas mikroprocesorius Renesas R5F10WMGAFB);
- **3.01** skaitikliams su srieginiu prijungimu G $\frac{3}{4}$, G 1, G $1\frac{1}{4}$, G $1\frac{1}{2}$ (kai naudojamas mikroprocesorius Nuvoton M258KE3AE);
- **2.02** skaitikliams su srieginiu prijungimu G 2 ir jungėmis DN50 (visais atvejais naudojamas mikroprocesorius Renesas R5F10WMGAFB).

Versijos numeris nurodytas prietaiso ženklinimo etiketėje (žymima SW:1.03, SW:3.01 arba SW:2.02).

5.4 Kalibravimo/reguliavimo procedūra

Naudojant optinę galvutę ir kompiuterį su programine įranga **W1 TOOL** įjungiamas skaitiklio patikros režimas. Optinė galvutė turi būti prijungta prie kompiuterio USB sąsajos.

Spec. laikiklio pagalba uždėjus optinę galvutę ant skaitiklio ir atidarius programos pradinį langą, langelyje „Com Port“ įvedamas kompiuterio prievado, prie kurio prijungta optinė galvutė, numeris.

Paspaudžiamas mygtukas „Wake Up Meter“, po to mygtukas „Enter Test Mode“.

Pervedus skaitiklį į patikros režimą, skaitiklio tūrio rodmenų skyra yra 1 ml.

Skaitiklio matavimo paklaidos įvertinamos, esant kontroliniams srautams, nurodytiems šio priedo 4.1 punkte, naudojant skaitiklio optinės sąsajos išvestį arba nuskaitant tūrio rodmenis skaitiklio skystųjų kristalų ekrane.

Tūrio impulsų vertė patikros režime pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė

Skaitiklio nuolatinis srautas Q_3 , m ³ /h	Tūrio impulso vertė patikros režime, litrai/imp.
1,6	0,001
2,5	0,002
4	0,004
6,3	0,005
10	0,010
16	0,015
25	0,020
40	0,025

Į darbo režimą skaitiklis pervedamas optinės galvutės ir kompiuterio su programine įranga **W1 TOOL** pagalba. Atidarius programos pradinį langą, paspaudžiamas mygtukas „**Wake Up Meter**“, po to mygtukas „**Enter User Mode**“, skaitiklis grįžta į darbo režimą. Skaitiklis grįžta į darbo režimą savaime, praėjus 24 valandoms nuo patikros režimo įjungimo.


6 Matavimų apsauga

6.1 Plombavimas


Skaitiklio korpusas yra neardomai uždarytas. Bet koks nesankcionuotas atidarymas nepažeidus korpuso yra neįmanomas. Atidarius viršutinį dangtelį, įsijungia skaitiklio korpuse sumontuotas apsauginis mygtukas ir skaitiklio rodmenų įtaise pasirodo klaidos kodas, kurio pirmasis skaitmuo yra „4“.

Skaitiklio su srieginiu prijungimu plombavimui po įrengimo yra numatytos kiaurymės skaitiklio korpuse (6 pav. a ir b).


Skaitikliui su jungėmis DN50 po įrengimo plombuojami tvirtinimo varžtai (6 pav. c)

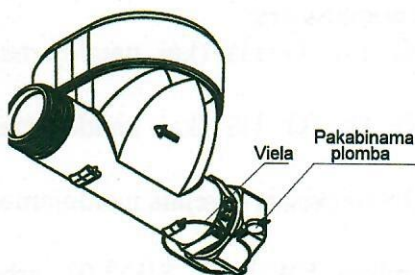

a) Skaitiklis su srieginiu
prijungimu G $\frac{3}{4}$ ir G 1

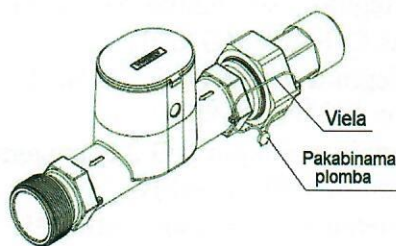

b) Skaitiklis su srieginiu prijungimu
G $1\frac{1}{4}$, G $1\frac{1}{2}$, G 2

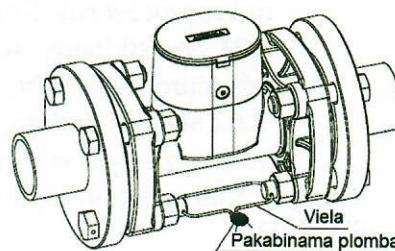

c) Skaitiklis su
jungėmis DN50

6 pav. Vandens skaitiklio QALCOSONIC W1 plombavimas po įrengimo

7 Ženklinimas ir užrašai

7.1 Informacija, kuri turi būti pateikta ant matavimo priemonės ir prie jos pridedama

Ant vandens skaitiklio korpuso dangtelio yra ši informacija:

- ES tipo tyrimo sertifikato numeris;
- gamintojo prekės ženklas;
- platintojo ženklas (jei taikoma);
- skaitiklio tipo žymėjimas;
- gamybos metai ir serijos numeris;
- matavimo vienetų žymėjimas: m^3 (rodoma skystųjų kristalų rodmenų įtaise);
- nuolatinis srautas Q_3 ;
- srautų santykis Q_3/Q_1 , žymimas raide R;
- temperatūros klasė, kai ji yra skirtinga, nei T30;
- didžiausias leidžiamasis darbinis slėgis (MAP);
- slėgio nuostolių klasė;
- skaitiklio srauto profilio jautrumo klasė;
- vėliausia skaitiklio pakeitimo data;
- programinės įrangos versijos numeris;
- IP kodas;

- QR kodas arba brūkšninis kodas;
- ryšio sąsaja NB-IoT (jei sumontuota skaitiklyje).

Ant vandens skaitiklio korpuso turi būti rodyklė srauto kryptį pažymėti.

7.2 Atitikties įvertinimo žymėjimas

Vandens skaitiklio ženklavimo etiketėje papildomai turi būti šie ženklai:

- „CE“ ženklas;
- papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro stačiakampis su įrašyta didžiąja raide „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
- paskelbtosios įstaigos, atlikusios atitikties vertinimą, numeris.

8 Sąrašas brėžinių, pridedamų prie sertifikato

Surinkimo brėžinys N10.0001.00.00-01, 2021-12-07.

Surinkimo brėžinys N10.0013.00.00-01, 2018-08-24.

Surinkimo brėžinys N14.0010.00.00-00, 2020-10-01.

Surinkimo brėžinys N10.0033.00.00-00, 2020-10-01.

Surinkimo brėžinys N14.013.00.00 W1 DN40 L300, 2020-12-11.

Surinkimo brėžinys N10.0052.100.00-00, 2021-10-15.

Surinkimo brėžinys N10.0055.100.00-00, 2021-10-15.

Surinkimo brėžinys N10.0043.00.00-00, 2020-12-11.

9 Sertifikatų istorija

Leidimas	Išleidimo data ir nuorodos Nr.	Aprašymas																																																				
1	2	3																																																				
LT-1621-MI001-034	2018-08-31, Nr. LEI-12-MP-076.18	Tipo tyrimo sertifikato pirmasis leidimas																																																				
LT-1621-MI001-034 Pirmasis pataisytas leidimas	2019-07-30, Nr. LEI-12-MP-088.19	1. Skaitiklis papildytas vandens temperatūros klase T50. 2. Pakeistas skaitiklio ženklinimo etiketės dizainas (1 pav.). 3. Dokumentas PL_QW1_V02, išleistas 2018-08-29, pakeistas dokumentu PL_QW1_V04, išleistu 2019-07-24.																																																				
LT-1621-MI001-034 Antrasis pataisytas leidimas	2019-12-09, Nr. LEI-12-MP-092.19	<table><tr><th colspan="4">Srautas, m³/h</th><th rowspan="2">R, Q₃/Q₁</th><th rowspan="2">Prijungimo būdas</th><th rowspan="2">Montavimo ilgis L, mm</th><th rowspan="2">Slėgio nuostolių klasė</th></tr><tr><th>Q₃</th><th>Q₄</th><th>Q₁</th><th>Q₂</th></tr><tr><td rowspan="5">1,6</td><td rowspan="5">2,0</td><td rowspan="5">0,004</td><td rowspan="5">0,0064</td><td rowspan="5">400</td><td>G ¾</td><td>80</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>105</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>110</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>165</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>170</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td rowspan="5">2,5</td><td rowspan="5">3,125</td><td rowspan="5">0,0031</td><td rowspan="5">0,005</td><td rowspan="5">800</td><td>G ¾</td><td>80</td><td>Δp 40</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>105</td><td>Δp 40</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>110</td><td>Δp 40</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>165</td><td>Δp 40</td></tr><tr><td>G ¾</td><td>170</td><td>Δp 40</td></tr></table>	Srautas, m³/h				R, Q₃/Q₁	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė	Q₃	Q₄	Q₁	Q₂	1,6	2,0	0,004	0,0064	400	G ¾	80	Δp 25	G ¾	105	Δp 25	G ¾	110	Δp 25	G ¾	165	Δp 25	G ¾	170	Δp 25	2,5	3,125	0,0031	0,005	800	G ¾	80	Δp 40	G ¾	105	Δp 40	G ¾	110	Δp 40	G ¾	165	Δp 40	G ¾	170	Δp 40
Srautas, m³/h				R, Q₃/Q₁	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm					Slėgio nuostolių klasė																																											
Q₃	Q₄	Q₁	Q₂																																																			
1,6	2,0	0,004	0,0064	400	G ¾	80	Δp 25																																															
					G ¾	105	Δp 25																																															
					G ¾	110	Δp 25																																															
					G ¾	165	Δp 25																																															
					G ¾	170	Δp 25																																															
2,5	3,125	0,0031	0,005	800	G ¾	80	Δp 40																																															
					G ¾	105	Δp 40																																															
					G ¾	110	Δp 40																																															
					G ¾	165	Δp 40																																															
					G ¾	170	Δp 40																																															
		2. Nauja skaitiklio ženklinimo etiketė su platintojo NeoVac ženklu.																																																				

Handwritten signature

1	2	3																																																																																																																																																																				
		3. Dokumentas PL_QW1_V04, išleistas 2019-07-24, pakeistas dokumentu PL_QW1_V05, išleistu 2019-08-21.																																																																																																																																																																				
LT-1621-MI001-034 Trečiasis pataisytas leidimas	2020-01-31, Nr. LEI-12-MP-098.20	1. Skaitiklyje papildomai gali būti sumontuotos šios belaidžio ryšio sąsajos: - RF 920,5 MHz; - NB-IoT, darbiniai dažniai B1, B3, B5, B8, B20, B28. 2. Dokumentas PL_QW1_V05, išleistas 2019-08-21, pakeistas dokumentu PL_QW1_V06, išleistu 2020-01-09.																																																																																																																																																																				
LT-1621-MI001-034 Ketvirtasis pataisytas leidimas	2020-08-25, Nr. LEI-12-MP-106.20	1. Skaitiklis papildytas modifikacijomis su papildomomis santykio $R(Q_3/Q_1) = 80$ ir $R(Q_3/Q_1) = 160$ vertėmis. 2. Skaitikliams, kurių prijungimo būdas $G \frac{3}{4}$ ir vardinis srautas $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, slėgio nuostolių klasė iš $\Delta p 25$ pakeista į $\Delta p 16$. 3. Skaitikliams, kurių prijungimo būdas $G \frac{3}{4}$ ir vardinis srautas $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, slėgio nuostolių klasė iš $\Delta p 40$ pakeista į $\Delta p 25$. 4. Naujos skaitiklio ženklinimo etiketės su platintojų ženklais (1p paveikslas). 5. Dokumentas PL_QW1_V06, išleistas 2020-01-09, pakeistas dokumentu PL_QW1_V08, išleistu 2020-07-22.																																																																																																																																																																				
LT-1621-MI001-034 Penktasis pataisytas leidimas	2020-10-21, Nr. LEI-12-MP-105.20	1. Skaitiklis papildytas šiomis naujomis modifikacijomis: <table><tr><th colspan="4">Srautas, m³/h</th><th rowspan="2">R, Q₃/Q₁</th><th rowspan="2">Prijungimo būdas</th><th rowspan="2">Montavimo ilgis L, mm</th><th rowspan="2">Slėgio nuostolių klasė</th></tr><tr><th>Q₃</th><th>Q₄</th><th>Q₁</th><th>Q₂</th></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,079</td><td>0,126</td><td>80</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,040</td><td>0,063</td><td>160</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,0252</td><td>0,040</td><td>250</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,016</td><td>0,0252</td><td>400</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,008</td><td>0,013</td><td>800*</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,079</td><td>0,126</td><td>80</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,040</td><td>0,063</td><td>160</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,0252</td><td>0,040</td><td>250</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>6,3</td><td>7,875</td><td>0,016</td><td>0,0252</td><td>400</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,125</td><td>0,200</td><td>80</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 63</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,0625</td><td>0,100</td><td>160</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 63</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,040</td><td>0,064</td><td>250</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 63</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,025</td><td>0,040</td><td>400</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 63</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,0125</td><td>0,020</td><td>800*</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 63</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,010</td><td>0,016</td><td>1000*</td><td>G 1¼</td><td>260</td><td>Δp 63</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,125</td><td>0,200</td><td>80</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,0625</td><td>0,100</td><td>160</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,025</td><td>0,040</td><td>400</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,0125</td><td>0,020</td><td>800*</td><td>G 1½</td><td>260</td><td>Δp 25</td></tr></table> Pastaba: * – šis srautų santykis galioja tik skaitikliams temperatūros klasės T30.	Srautas, m³/h				R, Q₃/Q₁	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė	Q₃	Q₄	Q₁	Q₂	6,3	7,875	0,079	0,126	80	G 1¼	260	Δp 25	6,3	7,875	0,040	0,063	160	G 1¼	260	Δp 25	6,3	7,875	0,0252	0,040	250	G 1¼	260	Δp 25	6,3	7,875	0,016	0,0252	400	G 1¼	260	Δp 25	6,3	7,875	0,008	0,013	800*	G 1¼	260	Δp 25	6,3	7,875	0,079	0,126	80	G 1½	260	Δp 16	6,3	7,875	0,040	0,063	160	G 1½	260	Δp 16	6,3	7,875	0,0252	0,040	250	G 1½	260	Δp 16	6,3	7,875	0,016	0,0252	400	G 1½	260	Δp 16	10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 1¼	260	Δp 63	10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 1¼	260	Δp 63	10,0	12,5	0,040	0,064	250	G 1¼	260	Δp 63	10,0	12,5	0,025	0,040	400	G 1¼	260	Δp 63	10,0	12,5	0,0125	0,020	800*	G 1¼	260	Δp 63	10,0	12,5	0,010	0,016	1000*	G 1¼	260	Δp 63	10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 1½	260	Δp 25	10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 1½	260	Δp 25	10,0	12,5	0,025	0,040	400	G 1½	260	Δp 25	10,0	12,5	0,0125	0,020	800*	G 1½	260	Δp 25
Srautas, m³/h				R, Q₃/Q₁	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm					Slėgio nuostolių klasė																																																																																																																																																											
Q₃	Q₄	Q₁	Q₂																																																																																																																																																																			
6,3	7,875	0,079	0,126	80	G 1¼	260	Δp 25																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,040	0,063	160	G 1¼	260	Δp 25																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,0252	0,040	250	G 1¼	260	Δp 25																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,016	0,0252	400	G 1¼	260	Δp 25																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,008	0,013	800*	G 1¼	260	Δp 25																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,079	0,126	80	G 1½	260	Δp 16																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,040	0,063	160	G 1½	260	Δp 16																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,0252	0,040	250	G 1½	260	Δp 16																																																																																																																																																															
6,3	7,875	0,016	0,0252	400	G 1½	260	Δp 16																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 1¼	260	Δp 63																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 1¼	260	Δp 63																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,040	0,064	250	G 1¼	260	Δp 63																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,025	0,040	400	G 1¼	260	Δp 63																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,0125	0,020	800*	G 1¼	260	Δp 63																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,010	0,016	1000*	G 1¼	260	Δp 63																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 1½	260	Δp 25																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 1½	260	Δp 25																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,025	0,040	400	G 1½	260	Δp 25																																																																																																																																																															
10,0	12,5	0,0125	0,020	800*	G 1½	260	Δp 25																																																																																																																																																															



1	2	3																																																																																																												
		2. Panaikinta skaitiklio versija su papildoma laidine M-Bus arba impulsų išvesties sąsaja. 3. Skaitikliams, kurių prijungimo būdas G 1 ir vardinis srautas $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, slėgio nuostolių klasė iš Δp 25 pakeista į Δp 16. 4. Skaitikliams, kurių prijungimo būdas G 1 ir vardinis srautas $Q_3 = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, slėgio nuostolių klasė iš Δp 40 pakeista į Δp 25. 5. Papildomas techninis aprašas skaitikliams $Q_3 = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ ir $Q_3 = 10 \text{ m}^3/\text{h}$: PL_QW1DN25-32_V01, išleistas 2020-10-19.																																																																																																												
LT-1621-MI001-034 Šeštasis pataisytas leidimas	2021-01-20, Nr. LEI-12-MP-111.21	1. Skaitiklis papildytas šiomis naujomis modifikacijomis su srieginiu prijungimu G2: <table><thead><tr><th colspan="4">Srautas, m³/h</th><th rowspan="2">R, Q_3/Q_1</th><th rowspan="2">Prijungimo būdas</th><th rowspan="2">Montavimo ilgis L, mm</th><th rowspan="2">Slėgio nuostolių klasė</th></tr><tr><th>Q_3</th><th>Q_4</th><th>Q_1</th><th>Q_2</th></tr></thead><tbody><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,125</td><td>0,200</td><td>80</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,0625</td><td>0,100</td><td>160</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>10,0</td><td>12,5</td><td>0,040</td><td>0,064</td><td>250</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>16,0</td><td>20,0</td><td>0,200</td><td>0,320</td><td>80</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>16,0</td><td>20,0</td><td>0,100</td><td>0,160</td><td>160</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>16,0</td><td>20,0</td><td>0,064</td><td>0,102</td><td>250</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>16,0</td><td>20,0</td><td>0,040</td><td>0,064</td><td>400</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>25,0</td><td>31,25</td><td>0,3125</td><td>0,500</td><td>80</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>25,0</td><td>31,25</td><td>0,156</td><td>0,250</td><td>160</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>25,0</td><td>31,25</td><td>0,100</td><td>0,160</td><td>250</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>25,0</td><td>31,25</td><td>0,0625</td><td>0,100</td><td>400</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr><tr><td>25,0</td><td>31,25</td><td>0,0312</td><td>0,050</td><td>800*</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16</td></tr></tbody></table> Pastaba: * – šis srautų santykis galioja tik skaitikliams temperatūros klasės T30. 2. Papildomas duomenų perdavimo protokolas CoAP skaitiklio ryšio sąsajoms. 3. Papildoma programinės įrangos versija skaitikliams su srieginiu prijungimu G2. Versijos numeris yra 1.02. 4. Papildomas techninis aprašas skaitikliams su srieginiu prijungimu G2: : PL_QW1DN40_V01, išleistas 2021-01-20.	Srautas, m³/h				R, Q_3/Q_1	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė	Q_3	Q_4	Q_1	Q_2	10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 2	300	Δp 16	10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 2	300	Δp 16	10,0	12,5	0,040	0,064	250	G 2	300	Δp 16	16,0	20,0	0,200	0,320	80	G 2	300	Δp 16	16,0	20,0	0,100	0,160	160	G 2	300	Δp 16	16,0	20,0	0,064	0,102	250	G 2	300	Δp 16	16,0	20,0	0,040	0,064	400	G 2	300	Δp 16	25,0	31,25	0,3125	0,500	80	G 2	300	Δp 16	25,0	31,25	0,156	0,250	160	G 2	300	Δp 16	25,0	31,25	0,100	0,160	250	G 2	300	Δp 16	25,0	31,25	0,0625	0,100	400	G 2	300	Δp 16	25,0	31,25	0,0312	0,050	800*	G 2	300	Δp 16
Srautas, m³/h				R, Q_3/Q_1	Prijungimo būdas	Montavimo ilgis L, mm					Slėgio nuostolių klasė																																																																																																			
Q_3	Q_4	Q_1	Q_2																																																																																																											
10,0	12,5	0,125	0,200	80	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
10,0	12,5	0,0625	0,100	160	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
10,0	12,5	0,040	0,064	250	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
16,0	20,0	0,200	0,320	80	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
16,0	20,0	0,100	0,160	160	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
16,0	20,0	0,064	0,102	250	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
16,0	20,0	0,040	0,064	400	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
25,0	31,25	0,3125	0,500	80	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
25,0	31,25	0,156	0,250	160	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
25,0	31,25	0,100	0,160	250	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
25,0	31,25	0,0625	0,100	400	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
25,0	31,25	0,0312	0,050	800*	G 2	300	Δp 16																																																																																																							
LT-1621-MI001-034 Septintasis pataisytas leidimas	2021-05-25, Nr. LEI-12-MP-114.21	1. Skaitiklio ženklavimo etiketės su naujų platintojų ženklais (1p paveikslas). 2. Naujas techninis aprašas visų dydžių skaitikliams: TM_QW1_V01_LT, išleistas 2021-05-05.																																																																																																												

1	2	3																																																																																																																												
LT-1621-MI001-034 Aštuntasis pataisytas leidimas	2021-06-14, Nr. LEI-12-MP-115.21	1. Papildomas duomenų perdavimo protokolas W-M-Bus-T2 skaitiklio RF ryšio sąsajoms. 2. Nauja programinės įrangos versija skaitikliams su srieginiu prijungimu G ¾, G 1, G 1¼, G 1½. Versijos numeris yra 1.03. 3. Dokumentas TM_QW1_V01_LT, išleistas 2021-05-05, pakeistas dokumentu TM_QW1_V02_LT, išleistu 2021-06-07.																																																																																																																												
LT-1621-MI001-034 Devintasis pataisytas leidimas	2021-10-28, Nr. LEI-12-MP-119.21	1. Papildoma dizaino versija skaitikliams su srieginiu prijungimu G ¾ ir G 1 („n“ dizaino versija). 2. Filtro-sietelio sumontavimo galimybė skaitiklio įtekėjimo atvamzdyje. Informacija apie slėgio nuostolių klases skaitikliams su filtru. 3. Atbulinio vožtuvo sumontavimo galimybė skaitiklio ištekėjimo atvamzdyje. 4. Papildomos laidinio ryšio sąsajos: M-Bus ir/arba laidinė impulsų išvestis (specialiai užsakant). 5. Skaitiklio ženklinimo etiketės su naujų platintojų ženklais (1 p paveikslas). 6. Dokumentas TM_QW1_V02_LT, išleistas 2021-06-07, pakeistas dokumentu TM_QW1_V03_LT, išleistu 2021-10-18.																																																																																																																												
LT-1621-MI001-034 Dešimtas pataisytas leidimas	2021-12-10, Nr. LEI-12-MP-116.21	1. Skaitiklis papildytas šiomis naujomis modifikacijomis su prijungimu jungėmis DN50: <table><tr><th colspan="4">Srautas, m³/h</th><th rowspan="2">R, Q₃/Q₁</th><th rowspan="2">Prijungimo būdas</th><th rowspan="2">Ilgis L, mm</th><th rowspan="2">Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtrą-sietelį</th></tr><tr><th>Q₃</th><th>Q₄</th><th>Q₁</th><th>Q₂</th></tr><tr><td>16</td><td>20,0</td><td>0,200</td><td>0,320</td><td>80</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>16</td><td>20,0</td><td>0,100</td><td>0,160</td><td>160</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>16</td><td>20,0</td><td>0,064</td><td>0,102</td><td>250</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>16</td><td>20,0</td><td>0,040</td><td>0,064</td><td>400*</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>25</td><td>31,25</td><td>0,3125</td><td>0,500</td><td>80</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>25</td><td>31,25</td><td>0,156</td><td>0,250</td><td>160</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>25</td><td>31,25</td><td>0,100</td><td>0,160</td><td>250</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>25</td><td>31,25</td><td>0,0625</td><td>0,100</td><td>400</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>25</td><td>31,25</td><td>0,0312</td><td>0,050</td><td>800*</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>40</td><td>50,0</td><td>0,500</td><td>0,800</td><td>80</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 40</td></tr><tr><td>40</td><td>50,0</td><td>0,250</td><td>0,400</td><td>160</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 40</td></tr><tr><td>40</td><td>50,0</td><td>0,160</td><td>0,256</td><td>250</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 40</td></tr><tr><td>40</td><td>50,0</td><td>0,100</td><td>0,160</td><td>400</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 40</td></tr><tr><td>40</td><td>50,0</td><td>0,050</td><td>0,080</td><td>800*</td><td>DN50</td><td>200</td><td>Δp 16/ Δp 40</td></tr></table>	Srautas, m³/h				R, Q₃/Q₁	Prijungimo būdas	Ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtrą-sietelį	Q₃	Q₄	Q₁	Q₂	16	20,0	0,200	0,320	80	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	16	20,0	0,100	0,160	160	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	16	20,0	0,064	0,102	250	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	16	20,0	0,040	0,064	400*	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	25	31,25	0,3125	0,500	80	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	25	31,25	0,156	0,250	160	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	25	31,25	0,100	0,160	250	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	25	31,25	0,0625	0,100	400	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	25	31,25	0,0312	0,050	800*	DN50	200	Δp 16/ Δp 16	40	50,0	0,500	0,800	80	DN50	200	Δp 16/ Δp 40	40	50,0	0,250	0,400	160	DN50	200	Δp 16/ Δp 40	40	50,0	0,160	0,256	250	DN50	200	Δp 16/ Δp 40	40	50,0	0,100	0,160	400	DN50	200	Δp 16/ Δp 40	40	50,0	0,050	0,080	800*	DN50	200	Δp 16/ Δp 40
Srautas, m³/h				R, Q₃/Q₁	Prijungimo būdas	Ilgis L, mm					Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtrą-sietelį																																																																																																																			
Q₃	Q₄	Q₁	Q₂																																																																																																																											
16	20,0	0,200	0,320	80	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
16	20,0	0,100	0,160	160	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
16	20,0	0,064	0,102	250	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
16	20,0	0,040	0,064	400*	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
25	31,25	0,3125	0,500	80	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
25	31,25	0,156	0,250	160	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
25	31,25	0,100	0,160	250	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
25	31,25	0,0625	0,100	400	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
25	31,25	0,0312	0,050	800*	DN50	200	Δp 16/ Δp 16																																																																																																																							
40	50,0	0,500	0,800	80	DN50	200	Δp 16/ Δp 40																																																																																																																							
40	50,0	0,250	0,400	160	DN50	200	Δp 16/ Δp 40																																																																																																																							
40	50,0	0,160	0,256	250	DN50	200	Δp 16/ Δp 40																																																																																																																							
40	50,0	0,100	0,160	400	DN50	200	Δp 16/ Δp 40																																																																																																																							
40	50,0	0,050	0,080	800*	DN50	200	Δp 16/ Δp 40																																																																																																																							

1	2	3																																																																										
		2. Skaitiklis papildytas šia nauja modifikacija su srieginiu prijungimu G2: <table><tr><th colspan="4">Srautas, m³/h</th><th rowspan="2">R, Q₃/Q₁</th><th rowspan="2">Prijungimo būdas</th><th rowspan="2">Ilgis L, mm</th><th rowspan="2">Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtra-sietelį</th></tr><tr><th>Q₃</th><th>Q₄</th><th>Q₁</th><th>Q₂</th></tr><tr><td>16</td><td>20,0</td><td>0,020</td><td>0,032</td><td>800*</td><td>G 2</td><td>300</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr></table> Pastaba: * – šis srautų santykis galioja tik skaitikliams temperatūros klasės T30. 3. Nauja programinės įrangos versija 2.02 skaitikliams su srieginiu prijungimu G 2. 4. Dokumentas TM_QW1_V03_LT, išleistas 2021-10-18, pakeistas dokumentu TM_QW1_V04_LT, išleistu 2021-12-07.	Srautas, m³/h				R, Q ₃ /Q ₁	Prijungimo būdas	Ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtra-sietelį	Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂	16	20,0	0,020	0,032	800*	G 2	300	Δp 16/ Δp 16																																																						
Srautas, m³/h				R, Q ₃ /Q ₁	Prijungimo būdas	Ilgis L, mm					Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtra-sietelį																																																																	
Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂																																																																									
16	20,0	0,020	0,032	800*	G 2	300	Δp 16/ Δp 16																																																																					
LT-1621-MI001-034 Vienuoliktasis pataisytas leidimas	2022-03-10, Nr. LEI-12-MP-123.22	1. Skaitiklis papildytas šia nauja modifikacija ilgio l = 115 mm: <table><tr><th colspan="4">Srautas, m³/h</th><th rowspan="2">R, Q₃/Q₁</th><th rowspan="2">Prijungimo būdas</th><th rowspan="2">Ilgis L, mm</th><th rowspan="2">Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtra-sietelį</th></tr><tr><th>Q₃</th><th>Q₄</th><th>Q₁</th><th>Q₂</th></tr><tr><td>1,6</td><td>2,0</td><td>0,020</td><td>0,032</td><td>80</td><td rowspan="12">G ¾</td><td rowspan="12">115*</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>1,6</td><td>2,0</td><td>0,010</td><td>0,016</td><td>160</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>1,6</td><td>2,0</td><td>0,0064</td><td>0,010</td><td>250</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>1,6</td><td>2,0</td><td>0,005</td><td>0,008</td><td>315</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>1,6</td><td>2,0</td><td>0,004</td><td>0,0064</td><td>400</td><td>Δp 16/ Δp 16</td></tr><tr><td>2,5</td><td>3,125</td><td>0,031</td><td>0,050</td><td>80</td><td>Δp 25/ Δp 25</td></tr><tr><td>2,5</td><td>3,125</td><td>0,0156</td><td>0,025</td><td>160</td><td>Δp 25/ Δp 25</td></tr><tr><td>2,5</td><td>3,125</td><td>0,010</td><td>0,016</td><td>250</td><td>Δp 25/ Δp 25</td></tr><tr><td>2,5</td><td>3,125</td><td>0,0062</td><td>0,010</td><td>400</td><td>Δp 25/ Δp 25</td></tr><tr><td>2,5</td><td>3,125</td><td>0,0031</td><td>0,005</td><td>800</td><td>Δp 25/ Δp 25</td></tr></table> Pastaba: * – skaitikliai gaminami tik pirminio dizaino versijos 2. Skaitiklio ženklinimo etiketės su naujų platintojų ženklais (1 p paveikslas – platintojai AQUAS NUEVAS, EWA, IREN, VandCenterSyd). 4. Dokumentas TM_QW1_V04_LT, išleistas 2021-12-07, pakeistas dokumentu TM_QW1_V05_LT, išleistu 2022-01-11.	Srautas, m³/h				R, Q ₃ /Q ₁	Prijungimo būdas	Ilgis L, mm	Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtra-sietelį	Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂	1,6	2,0	0,020	0,032	80	G ¾	115*	Δp 16/ Δp 16	1,6	2,0	0,010	0,016	160	Δp 16/ Δp 16	1,6	2,0	0,0064	0,010	250	Δp 16/ Δp 16	1,6	2,0	0,005	0,008	315	Δp 16/ Δp 16	1,6	2,0	0,004	0,0064	400	Δp 16/ Δp 16	2,5	3,125	0,031	0,050	80	Δp 25/ Δp 25	2,5	3,125	0,0156	0,025	160	Δp 25/ Δp 25	2,5	3,125	0,010	0,016	250	Δp 25/ Δp 25	2,5	3,125	0,0062	0,010	400	Δp 25/ Δp 25	2,5	3,125	0,0031	0,005	800	Δp 25/ Δp 25
Srautas, m³/h				R, Q ₃ /Q ₁	Prijungimo būdas	Ilgis L, mm					Slėgio nuostolių klasė: be filtro/sumontavus filtra-sietelį																																																																	
Q ₃	Q ₄	Q ₁	Q ₂																																																																									
1,6	2,0	0,020	0,032	80	G ¾	115*	Δp 16/ Δp 16																																																																					
1,6	2,0	0,010	0,016	160			Δp 16/ Δp 16																																																																					
1,6	2,0	0,0064	0,010	250			Δp 16/ Δp 16																																																																					
1,6	2,0	0,005	0,008	315			Δp 16/ Δp 16																																																																					
1,6	2,0	0,004	0,0064	400			Δp 16/ Δp 16																																																																					
2,5	3,125	0,031	0,050	80			Δp 25/ Δp 25																																																																					
2,5	3,125	0,0156	0,025	160			Δp 25/ Δp 25																																																																					
2,5	3,125	0,010	0,016	250			Δp 25/ Δp 25																																																																					
2,5	3,125	0,0062	0,010	400			Δp 25/ Δp 25																																																																					
2,5	3,125	0,0031	0,005	800			Δp 25/ Δp 25																																																																					
LT-1621-MI001-034 Dvyliktasis pataisytas leidimas	2022-09-20, Nr. LEI-12-MP-128.22	1. Skaitiklyje gali būti naudojami šių tipų mikroprocesoriai: - 16 bitų mikroprocesorius Renesas R5F10WMGAFB (visų modifikacijų skaitikliuose); - 32 bitų Nuvoton M258KE3AE mikroprocesorius (skaitikliuose su srieginiu prijungimu G ¾, G 1, G 1¼ ir G 1½). 2. Nauja programinės įrangos versija 3.01 skaitikliams, kuriuose sumontuotas mikroprocesorius Nuvoton M258KE3AE.																																																																										

M. M.







1	2	3
		3. Skaitiklio ženklinimo etiketė su naujo platintojo ženklu (1 p paveikslas – platintojas TENNACOLA).
LT-1621-MI001-034 Tryliktasis pataisytas leidimas	2022-12-28, Nr. LEI-12- MP-131.22	1. Skaitiklis papildytas atbulinio srauto matavimo funkcija. 2. Skaitiklio ženklinimo etiketės su naujų platintojų ženklais (1 p paveikslas – platintojai Watercare, PAVIA ACQUE ir GSA). 3. Techninis aprašas TM_QW1_V05_LT, išleistas 2022-01-11, pakeistas techniniu aprašu PE_QW1_V13_EN, išleistu 2022-12.

cl. m. 25



Pos.	Description	Qty.
1	Housing DN15	1
2	Insert assembly (DN15)	1
3	Top cover	1
4	Top cover lid	1
5	Antenna	1
6	Strainer D20	1
7	SMP bottom assembly	1
8	SMP top assembly	1


Configuration	L (length, mm)
DN15 L80	80
DN15 L105	105
DN15 L110	110
DN15 L115	115
DN15 L165	165
DN15 L170	170

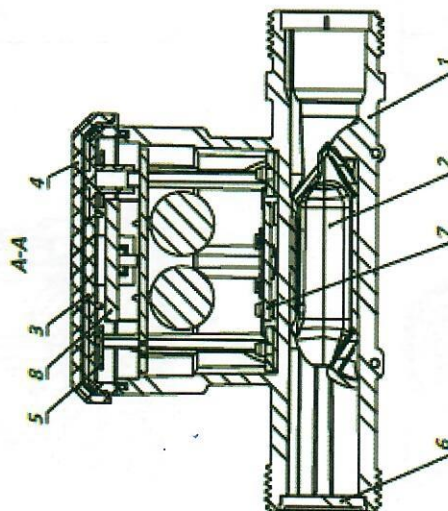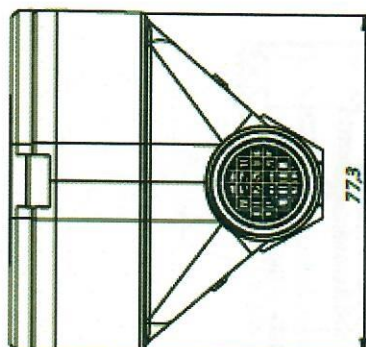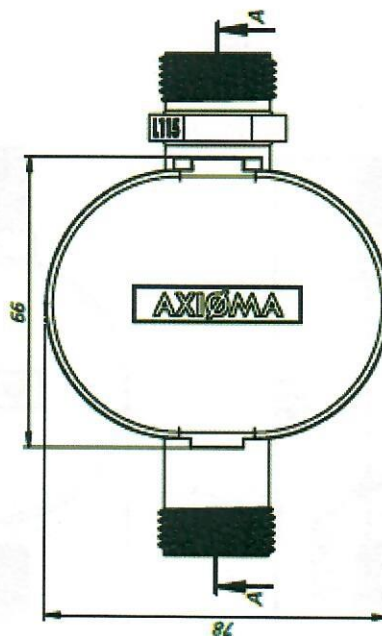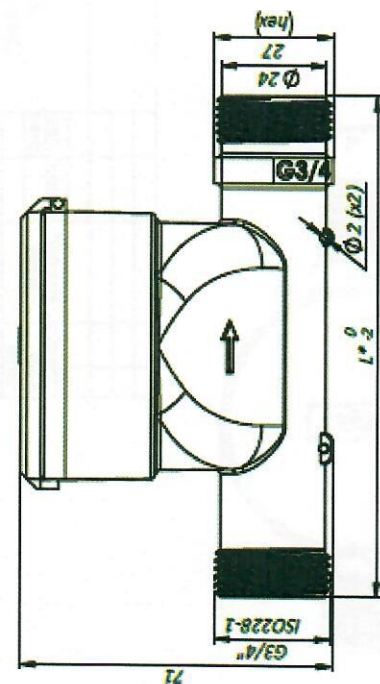

* - configurations of different lengths - see table No. 1





AXIOMA		AXIOMA	
Water meter		Water meter	
"Galcosonic W1 DN15"		"Galcosonic W1 DN15"	
N10.0001.00.00-01		N10.0001.00.00-01	
A3		A3	

Handwritten signature

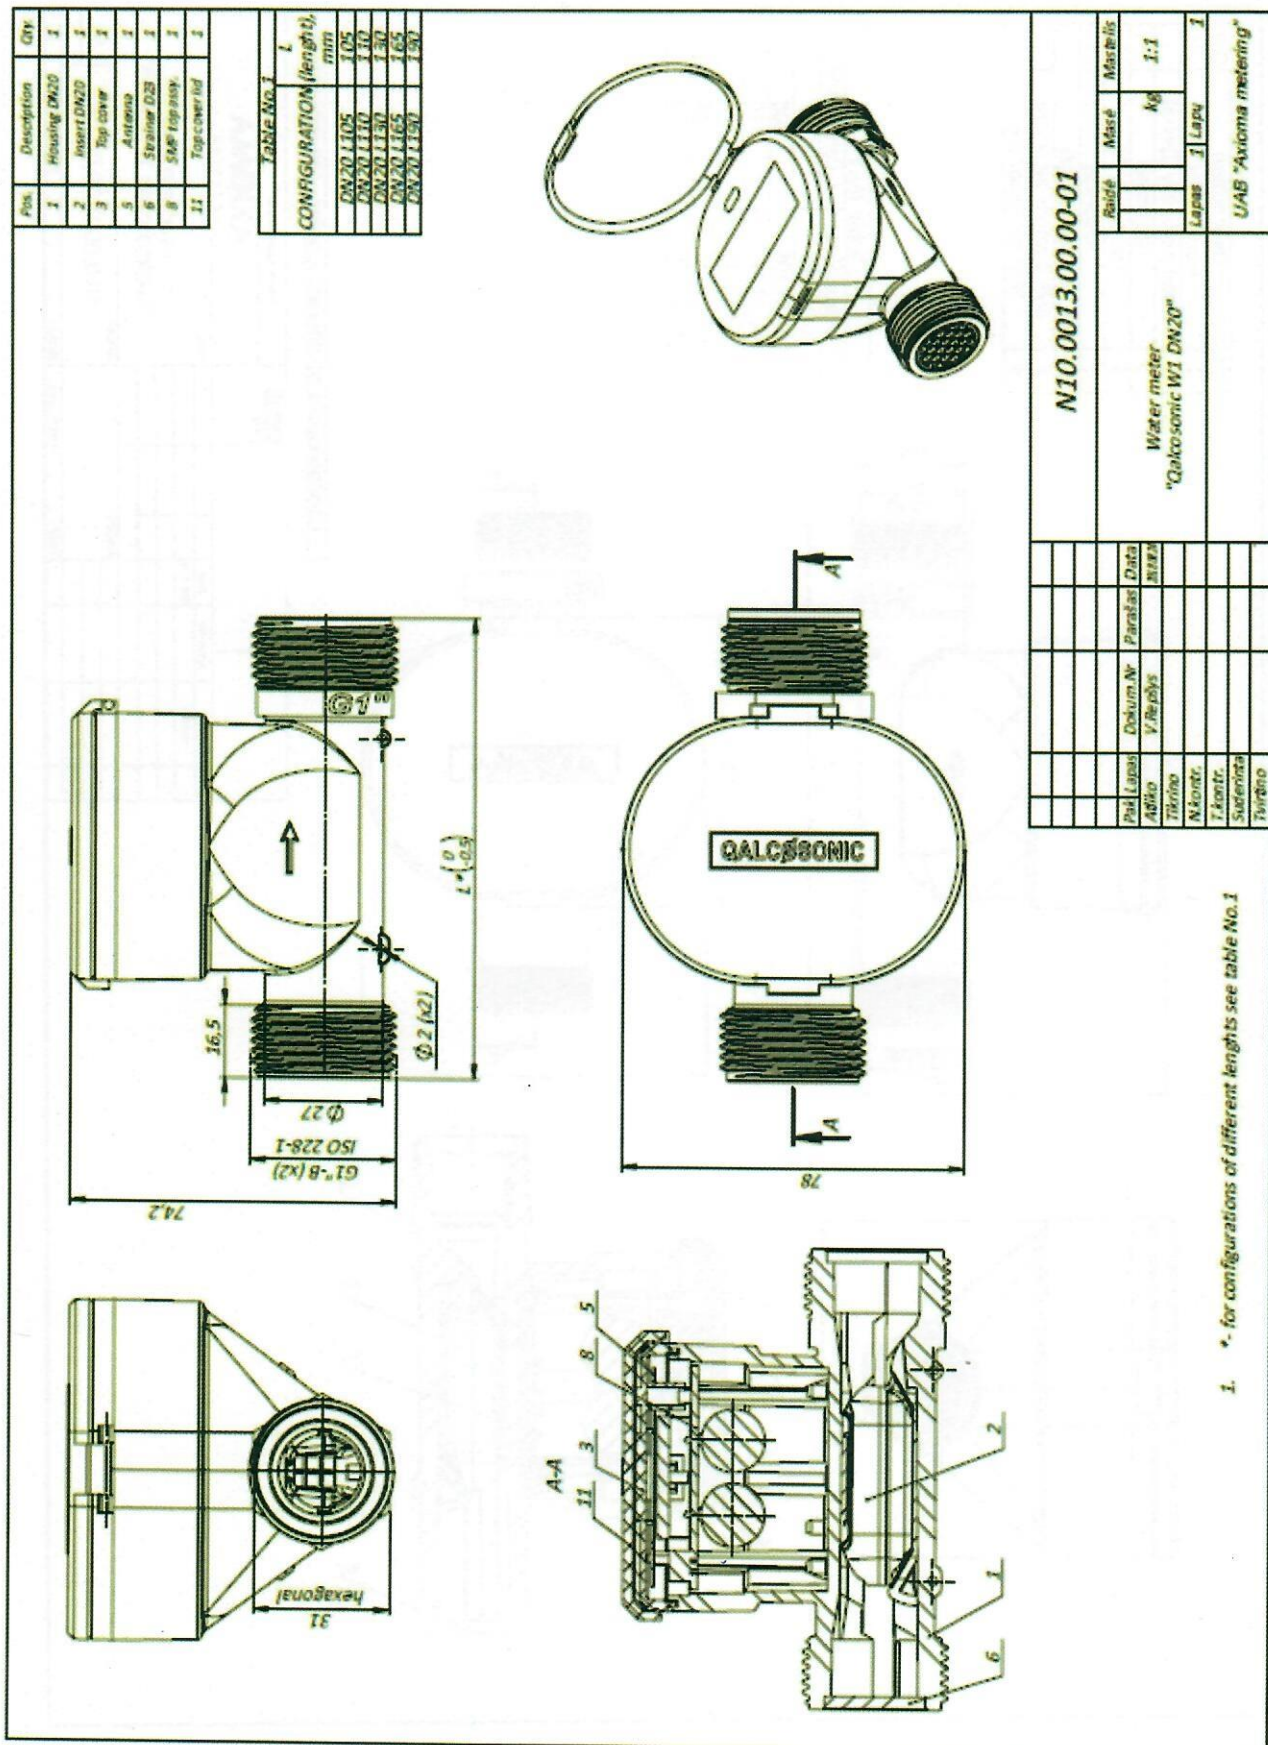




Poz.	Part No	Description	Qty.
1	N14.0010.00.01-03	Housing DN25 L260	1
2	N14.0011.01.01-03	Insert DN25 bottom	1
3	N14.0011.02.01-03	Insert DN25 TOP	1
4	N10.0033.02.01-03	Inner shell	1
5	N10.0033.00.02-02	Outer shell	1
6	N10.0033.00.05-00	Cover lid	1
7	N10.0033.02.02-00	Battery holder	1
8	N14.0013.00.06-00	Strainer DN25	1
9	N14.0010.03.05	Plastic rivet	2
10	N10.0033.00.03-02	Steel metal spring	2
11	N10.0033.00.04-00	PCB plate 10mm	2
12	N10.0001.05.00-02	SMP bottom case	1
13	N10.0033.00.02.04-00	Top PCB	1
14	-	Cable	1
15	N10.0033.02.07-00	Antenna	1
16	SP39A0300070	Screw 3.0x7	8
17	-	D-Cell battery	1
18	SP39A0300100E	Screw 3.5x10 Inox	2
19	W1025-W149025000	Check valve "Water"	1
20	-	Potting compound	1

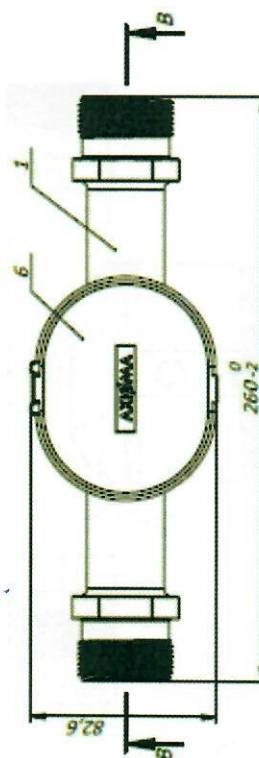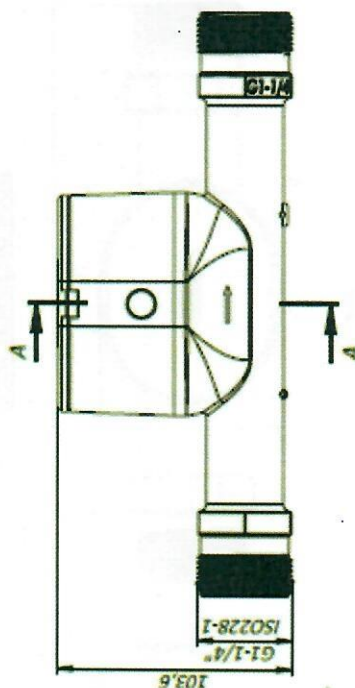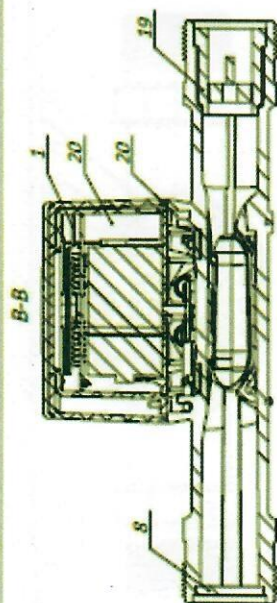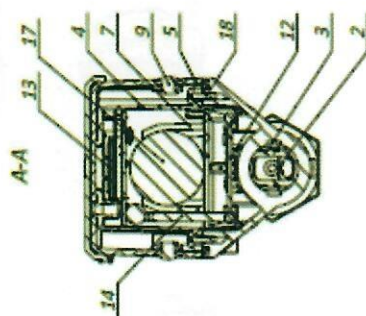

View without top parts

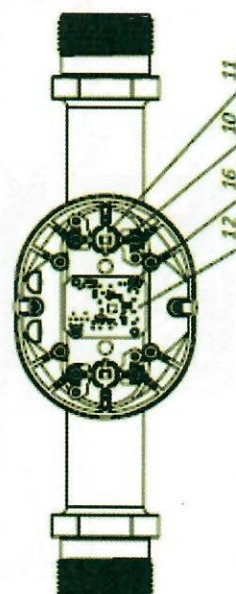

AXIOMA		REVISION	
Water meter "W1 DN25 L260"		1:2	
N14.0010.00.00-00		A3	
DATE		SCALE	
SIGNATURE		REMARKS	
NAME		DATE	
REVISION		REVISION	

Handwritten signature








LIETUVOS
ENERGETIKOS
INSTITUTAS

ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO
IR BANDYMŲ LABORATORIJA


ES tipo tyrimo sertifikato Nr. LT-1621-MI001-034,
tryliktojo pataisyto leidimo,
išduoto 2022-12-28, priedas

lapas 18/lapų sk. 26


Pos.	Partijos	Pavadinimas	Qty.
1	N10.0033.00.01-06	Housing DN32 L260	1
2	N10.0033.01.02-05	Insert DN32 bottom	1
3	N10.0033.01.01-04	Insert DN32 top	1
4	N10.0033.02.01-03	Inner shell	1
5	N10.0033.00.02-02	Outer shell	1
6	N10.0033.00.05-00	Cover lid	1
7	N10.0033.02.02-00	Battery holder	1
8	N10.0033.00.05-00	Strainer DN32	1
9	N14.0010.03.05	Plastic rivet	2
10	N10.0033.00.03-02	Sheet metal spring	2
11	N10.0033.00.04-00	PCB plate 10mm	2
12	N10.0001.05.00-02	SMP bottomassy.	1
13	N10.0033.00.02.04.00	Top PCB	1
14	N10.0033.02.07-00	Antenna	1
15	-	Cable	1
16	3P39A0300070	Screw 3.0x7	8
17	3P39A0350100E	Screw 3.5x10 Inox	2
18	-	D-Cell battery	1
19	-	Poling compound	1

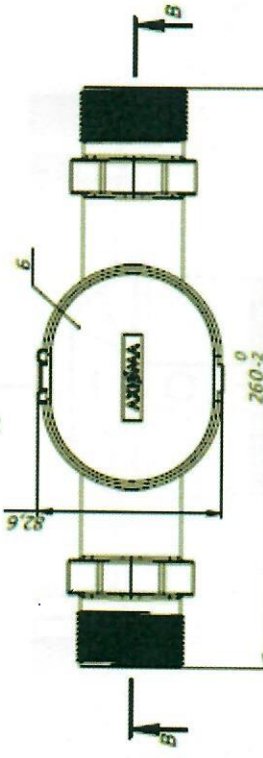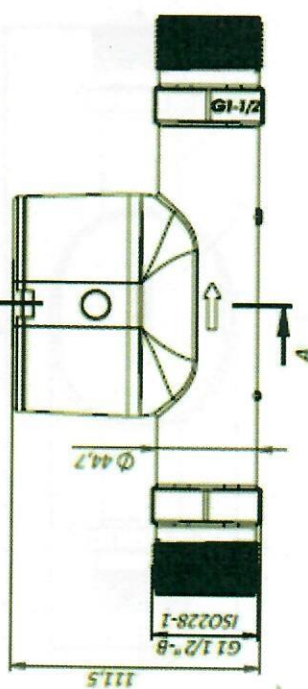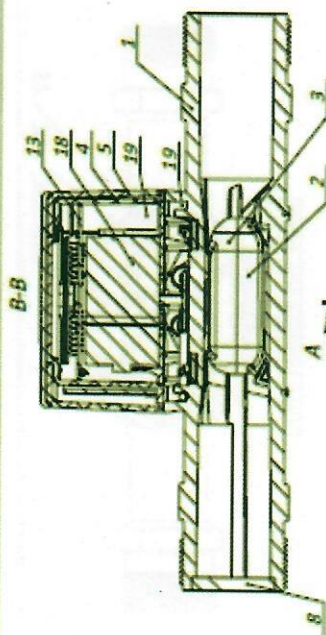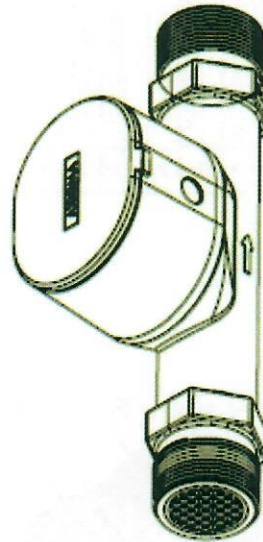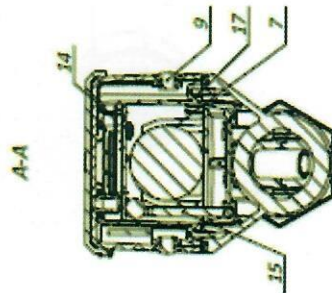



View without top parts

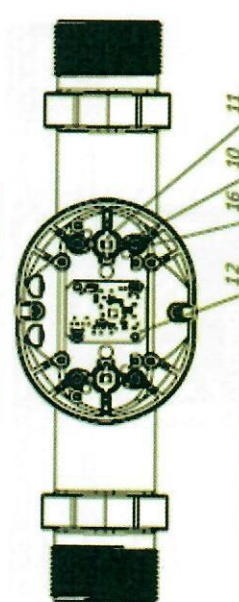

AXIOMA		WATER MEASUREMENT	
Water meter "W1 DN32 L260"		1:2	
N10.0033.00.00-00		A3	
DATE		DATE	
SIGNATURE		SIGNATURE	
NAME		NAME	
MATERIAL		MATERIAL	
VOLUME		VOLUME	
SCALE		SCALE	

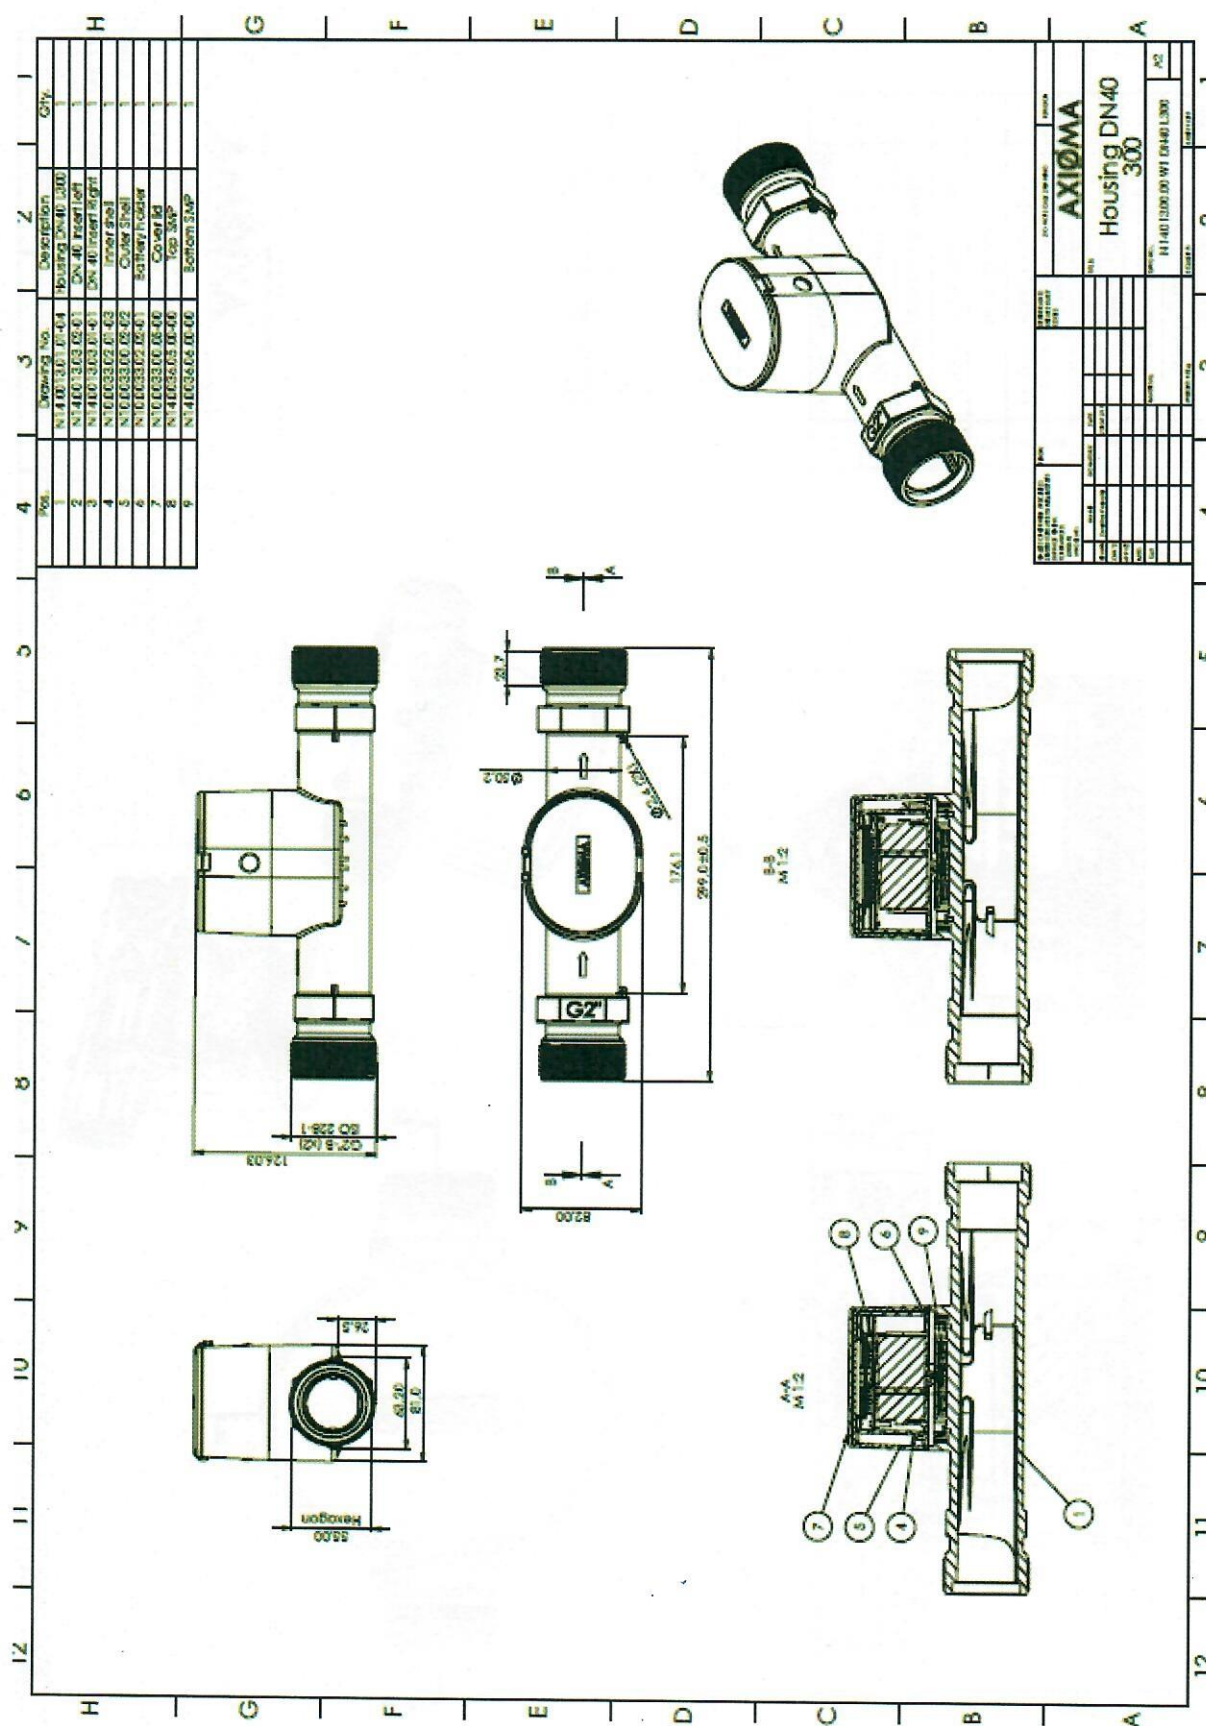

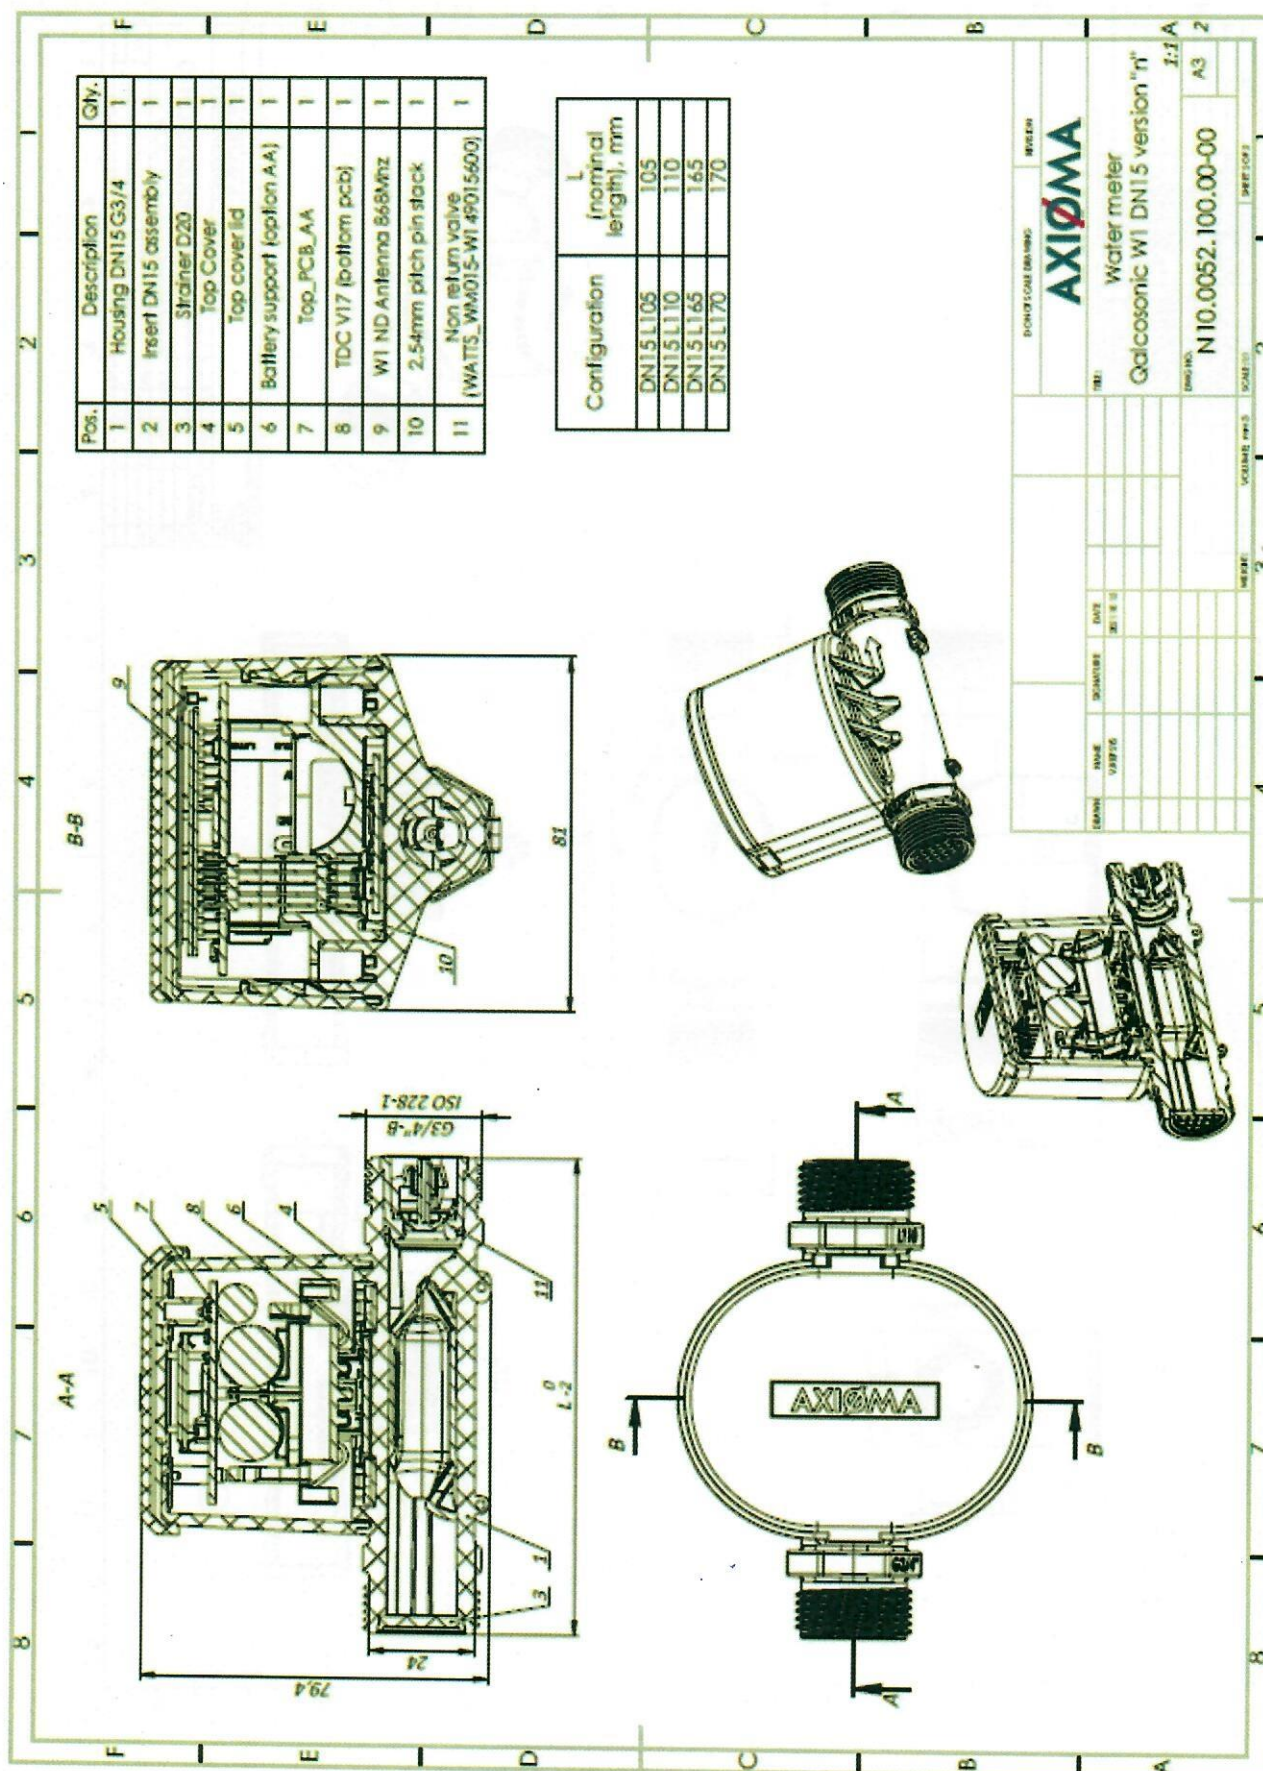

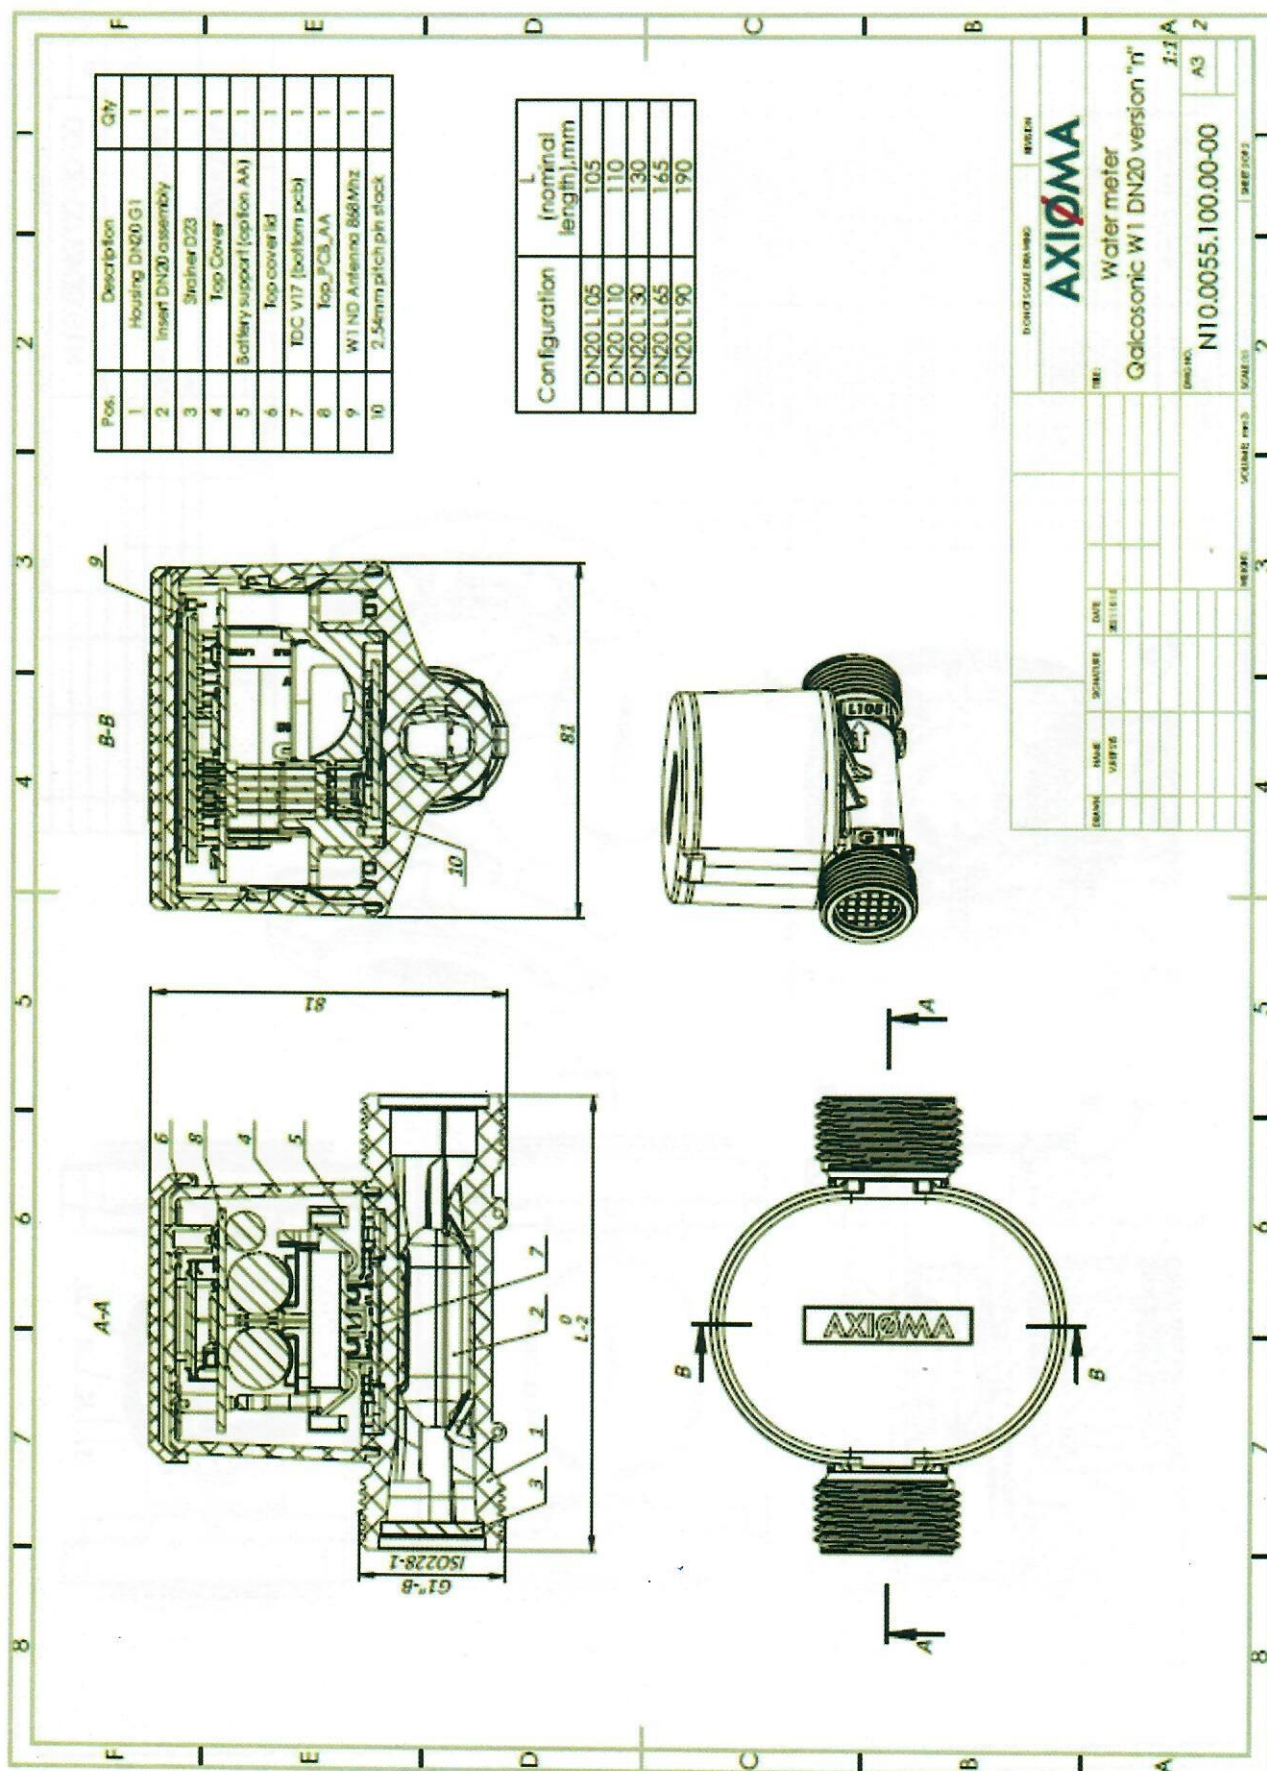

Handwritten signature






LIETUVOS
ENERGETIKOS
INSTITUTAS

ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO
IR BANDYMŲ LABORATORIJA

ES tipo tyrimo sertifikato Nr. LT-1621-MI001-034,
tryliktojo pataisyto leidimo,
išduoto 2022-12-28, priedas

lapas 22/lapų sk. 26

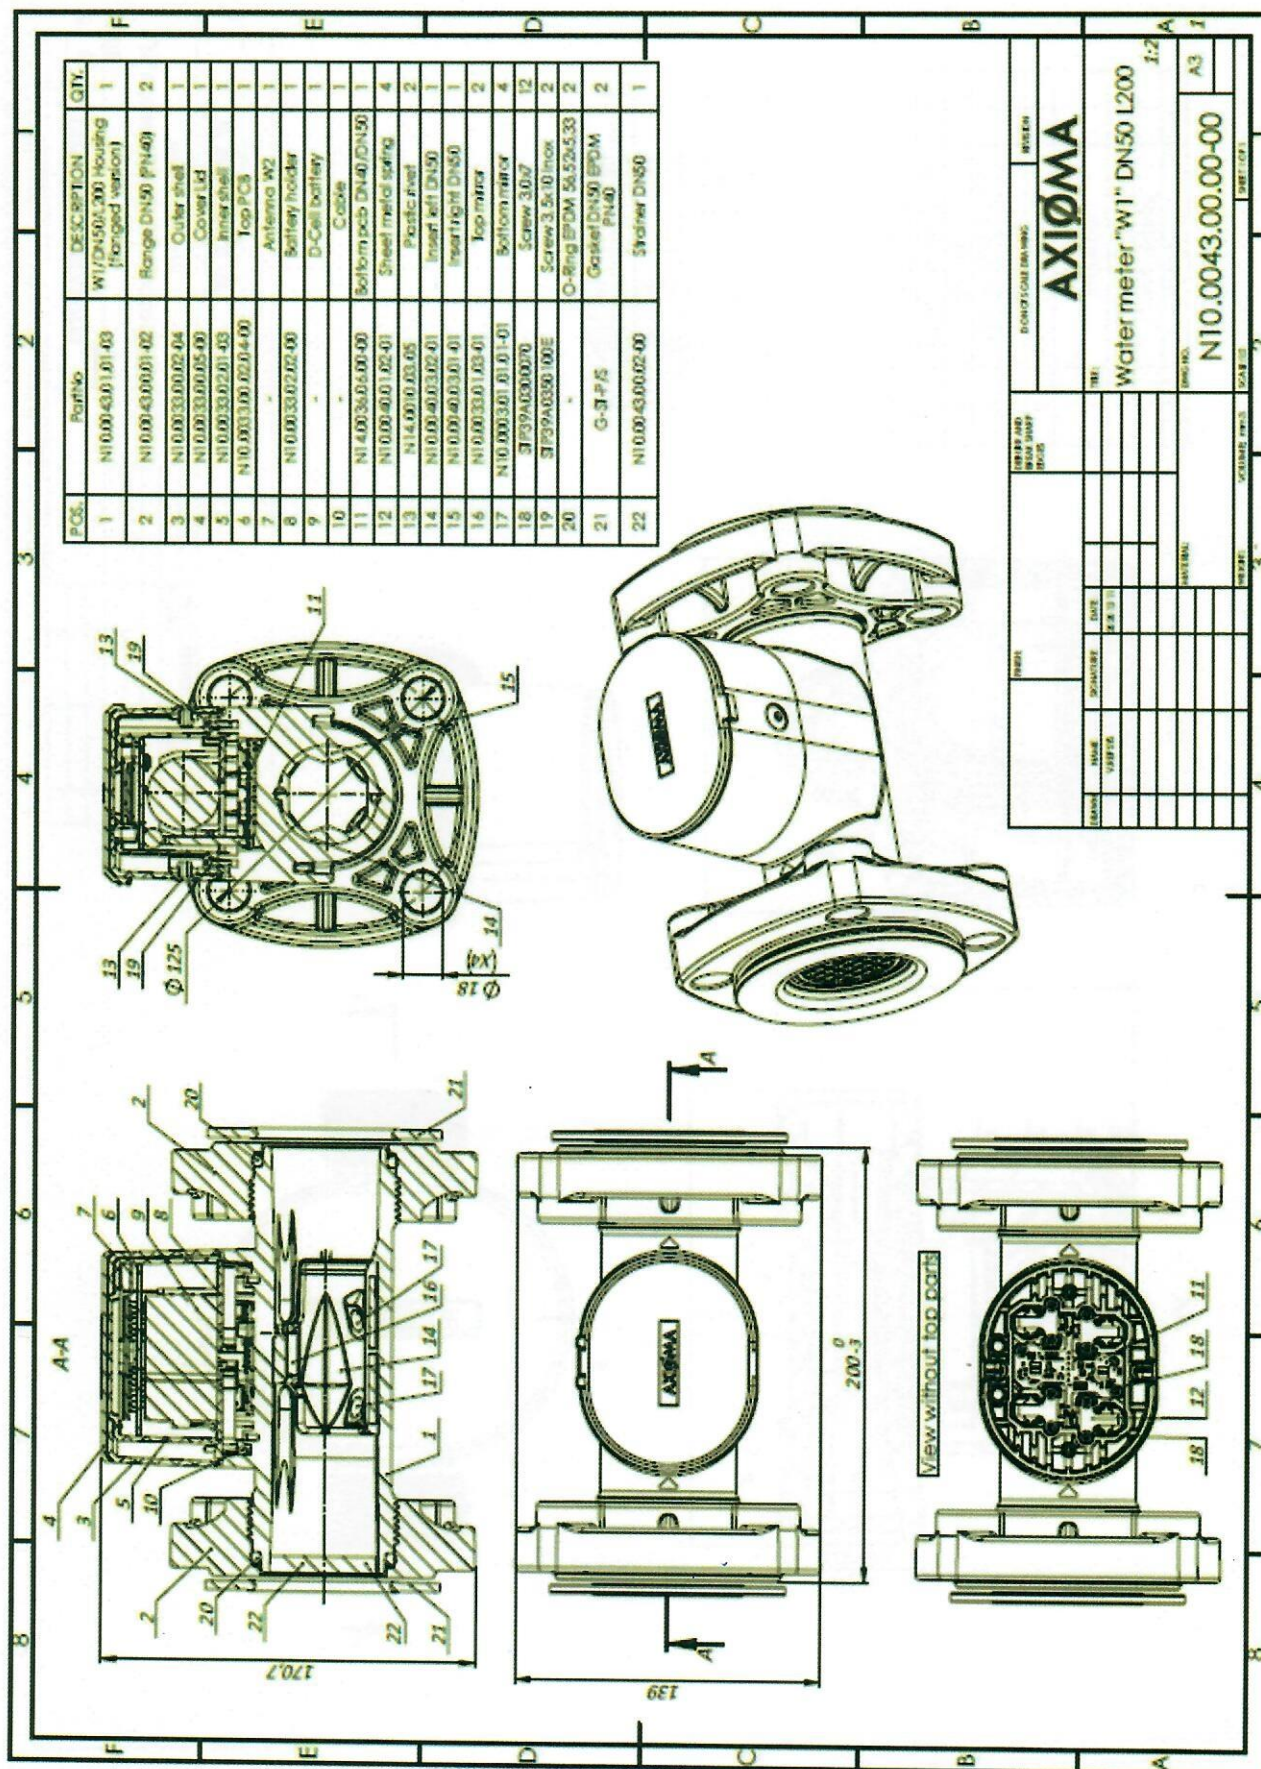

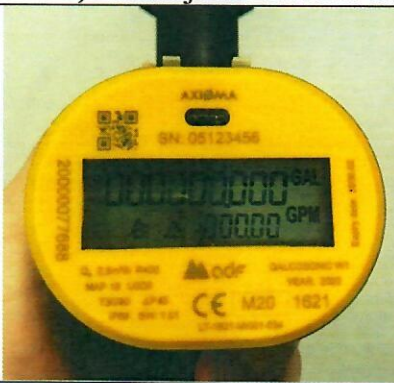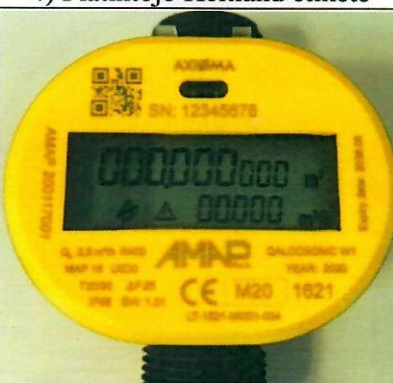	
1) Platintojo Neovac etiketė	2) Platintojo DIAM etiketė
	
3) Platintojo HT GROUP etiketė	4) Platintojo Heitland etiketė
	
5) Platintojo ADF etiketė	6) Platintojo AMAP etiketė
	
7) Platintojo OSE etiketė	8) Platintojo GSP etiketė



9) Platintojo EQUYSIS etiketė



10) Platintojo AQP etiketė



11) Platintojo SECAM etiketė



12) Platintojo RKG etiketė



13) Platintojo Hydro Control etiketė



14) Platintojo NSVA etiketė



15) Platintojo VASYD etiketė



16) Platintojo ASIS etiketė



17) Platintojo VERTO etiketė



18) Platintojo ETRA etiketė



19) Platintojo KIWA etiketė



20) Platintojo PUBLIACQUA etiketė



21) Platintojo ASA etiketė



22) Platintojo Evides etiketė







23) Platintojo acea etiketė



24) Platintojo APS etiketė

clm

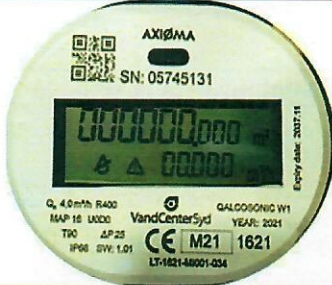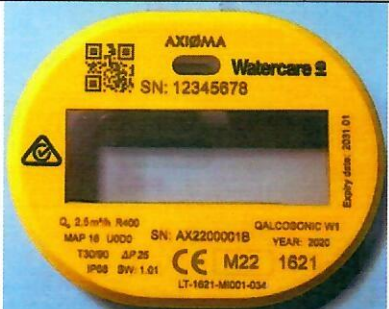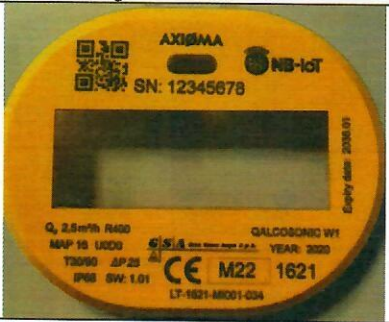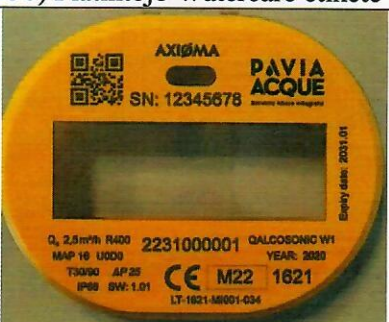	
25) Platintojo AQUAS NUEVAS etiketė	26) Platintojo EWA etiketė
	
27) Platintojo IREN etiketė	28) Platintojo VandCenterSyd etiketė
	
29) Platintojo TENNACOLA etiketė	30) Platintojo Watercare etiketė
	
31) Platintojo GSA etiketė	32) Platintojo PAVIA ACQUE etiketė

1p pav. Skaitiklio etiketės su platintojų ženklais